

変異株にも対応！

新型コロナウイルス

# PCR 検査 サービス

SARSコロナウイルス核酸キット「コバスSARS-CoV-2」

- ✓ 陰性・陽性検査証明書の発行可能  
※英文での発行も対応しております
- ✓ 検体回収は郵送or 集荷のどちらにも対応可能  
※集荷対応はエリア・検体数量によります
- ✓ 弊社に検体到着後**最短24時間以内**の結果報告  
※実際の日数に関してはお申込み時に調整致します

このような時にPCR検査をお勧めします。

- 病院で行われている「**精度の高い検査**」を受けたい。
- **抗原検査で陰性**だったけど、**風邪に似た症状**が続いて不安。

## 【ご利用実績】

- ▶ 医療機関    ▶ 訪問看護ステーション    ▶ 調剤薬局
- ▶ 医療機器メーカー    ▶ 運輸業    ▶ スポーツ団体
- ▶ 商業施設（食品スーパー）    ▶ 老人ホーム関連事業等



※写真はイメージです。

×[唾液]ではなく  
○[鼻腔]から検体採取



医療機関で一般的に用いられる「鼻咽頭」と高い一致率が認められている「鼻腔」から検体を自己採取します。

製薬業界の最大手  
ロシュ社検査システム



製薬業界の世界最大手ロシュ社（スイス）の検査試薬と分析装置を使用し、高精度な検査品質を保持しています。

県登録の衛生検査所  
徹底した検査体制



※写真はイメージです。

臨床検査に関する法律で定められた施設基準や検査体制を満たしている登録衛生検査所での検査を実施しています。

## 衛生検査所(県登録)で高精度な分析

### PCR検査のグローバル企業/ロシュ社製の検査システム

#### 【国立感染症研究所】ロシュ社製PCR検査の評価結果

陽性一致率	100%
陰性一致率	100%

※国立感染症研究所(感染研)から供与されたSARS-CoV-2感染臨床検体パネルを用い、感染研にて実施された試験結果と比較

#### 【国立医薬品食品衛生研究所】核酸増幅検査薬の試験結果

	RNA精製	反応系に持ち込む計 算上の検体量( $\mu$ L)	43000 コピー/mL	17000 コピー/mL	4300 コピー/mL	1700 コピー/mL	430 コピー/mL	170 コピー/mL	0 コピー/mL
ロシュ社製	有	216	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
国内メーカー A社	無	5	100%	100%	100%	100%	83%	33%	0%
国内メーカー B社	無	8	100%	100%	100%	67%	17%	0%	0%


※同研究所がCOVID-19診断用核酸増幅検査薬の信頼性を確認する目的で実施した試験結果から一部抜粋。模擬ウイルスを希釈した43000~0(コピー/mL)までの7種の溶液を使用し、各製品でそれぞれ6回の結果を取得。N=6の試験結果のうち「陽性」と判断された回数の割合を「%」で表示。  
※43000コピー/mLの濃度は、感染研が提示する検査法を用いた場合「50コピー/反応」に相当する。

Roche

F. Hoffmann-La Roche, Ltd.

本キットは(略称)ロシュ社製です。  
同社はスイスのバーゼルに本拠を置く  
世界的な製薬・ヘルスケア企業です。  
※日本法人は1932年に設立

## お申込・検査・結果通知までの流れ

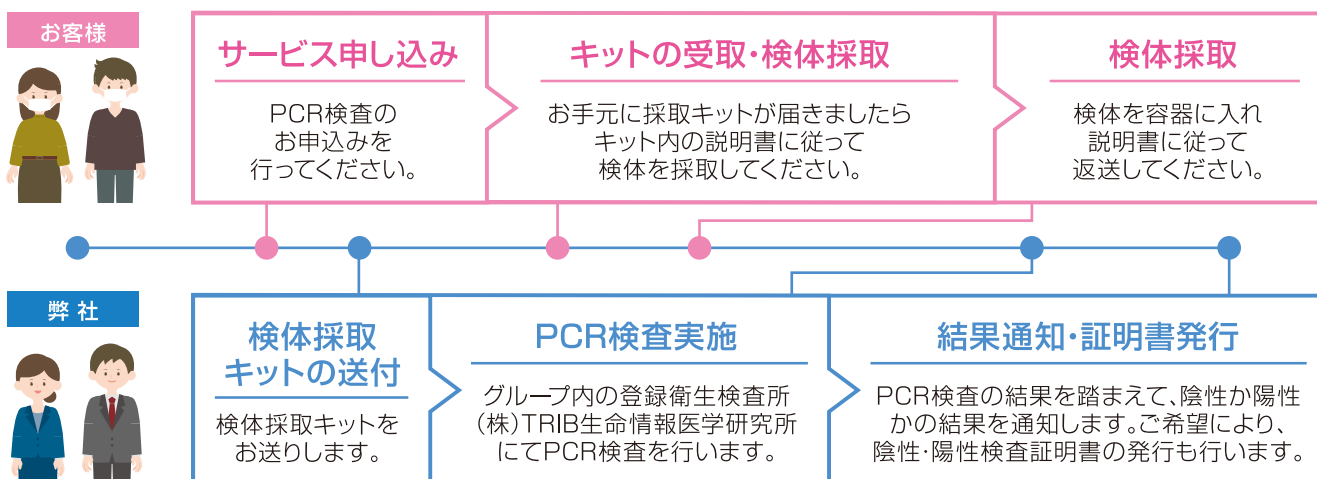

#### ■ 陰性・陽性検査証明書に関する注意点

陰性・陽性検査証明書に関しては申し込みがあったもののみ発行致します。利用用途や状況・基準によっては、確実な受理が保証されるものではありません。万が一不受理であった場合でも、当社では一切の責任は負いかねます。

## PCR検査会社

 **株式会社TRIB** 生命情報医学研究所  
Institute Bioinformatics

設立：2020年4月1日

本社：東京都中央区日本橋本町1-1-8 日本橋本町1丁目ビル10階

ラボ：埼玉県所沢市下安松1510-3

事業：遺伝子関連、染色体に関する検査事業/埼玉県衛生検査所登録番号第94号



## PCR検査へのお申込み・お問い合わせ

[専用サイトからお申し込み下さい]

株式会社TRIB TEL.03-6231-0072

<https://www.tr-covidkit.com>

